

Pécsi Tudományegyetem

Közbeszerzési Igazgatóság

Közbeszerzési Főosztály

Kérelmező: Medirex Zrt.

Székhely: 1142 Budapest, Szatmár utca 46/A.

Adószám: 11909879-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-044186

Bíróné Dr. Czeininger Mariann részére**Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem**

Tisztelt Bíróné Dr. Czeininger Mariann!

Alulírott Tóth Ákos, mint a Medirex Zrt. cégjegyzésre jogosult képviselője, a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: ajánlatkérő) „Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része kapcsán a 2017. 06. 06-án kézhez kapott írásbeli összegezés, valamint a 2017. 06. 07-én történt hivatalos iratbetekintés során szerzett információk és a Kbt. 80. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített jogosultság alapján és a biztosított törvényes határidőn belül, továbbá a Kbt. 80. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel előzetes vitarendezési kérelmet terjeszték elő a nyertesként kihirdetett Anamed Kft. ajánlatának érvényességével szemben.

1. Anamed Kft. a 2. részajánlati körben BeneView T1 (TDS dokkoló állomással) nevezetű terméket ajánlott a moduláris monitor elnevezésű termék kapcsán (Anamed Kft. ajánlata 11. oldal). A BeneView T1 termék egy 5"-os kijelzővel rendelkező, transzport monitor funkciókat is ellátni képes multi-paraméter modul, amelyhez valóban elérhető a TDS elnevezésű dokkoló állomás.

Piaci információink alapján egyértelmű, hogy a megajánlott termék (BeneView T1 (TDS dokkoló állomással) – amely a gyártó http://www.mindray.com/en/product/BeneView_TDS.html honlapján is megtekinthető) nem teljesíti az alábbi, Ajánlatkérő által támasztott elvárásokat, amelyek egyértelműen egy önálló moduláris, min. 15"-os érintőképernyővel rendelkező betegőrző monitorra vonatkoznak és nem az előírásokban egyébként szintén szereplő min. 5"-os kijelzővel rendelkező multi-paraméter modulra:

Moduláris betegőrző monitor, amely a későbbiekben további modulokkal továbbfejleszthető	Igen	
Színes LCD/TFT érintőképernyő min. 15"	Igen	
Egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék, csatornák száma (nem összes EKG elvezetés módban) min. 8	Igen	
Magyar nyelvű szoftver	Igen	
Újszülött/gyermek és felnőtt üzemmódok	Igen	
Központi monitorrendszerbe köthető	Igen	
Hálózati és akkumulátoros üzemmód	Igen	
Akkumulátoros üzemmód min. 120 perc	Igen	
Monitor súlya max. 12 kg	Igen	

Nem értjük, hogy a megajánlott 5"-os kijelzővel rendelkező multi-paraméter modul és a hozzá csatlakoztatható dokkoló munkaállomás hogyan teljesítik az Anamed Kft. által megajánlott paraméterek között megadott 19"-os színes érintőképernyős moduláris monitor terméket, amely a fent felsorolt további elvárásoknak is megfelel.

2. A 2. részajánlati körben a „Transzport esetén önállóan is használható, kijelzővel rendelkező multi-paraméter modul minden monitorhoz” eszköz kapcsán értékelési szempont volt a „Beépített hordfűl, amellyel együtt a moduláris monitorba helyezhető” paraméter, amelyre Anamed Kft. „igen” választ adott.

Piaci információink alapján egyértelmű, hogy a megajánlott termék (BeneView T1 (TDS dokkoló állomással) – amely a gyártó http://www.mindray.com/en/product/BeneView_TDS.html honlapján is megtekinthető) nem teljesíti az értékelési szempontot.

A BeneView T1 típusú multi-paraméter modul nem rendelkezik beépített hordfűlrel, arra a gyártónak kizárólag külsőleg rászerezhető vagy a TDS dokkolóegységre épített megoldása van.

Az értékelési szempont második részének teljesülése pedig egyszerűen értelmezhetetlen, hiszen a megajánlott termékek között nem szerepel moduláris monitor, amelybe a megajánlott, de álláspontunk szerint beépített hordfűlrel nem rendelkező BeneView T1 multi-paraméter modul behelyezhető lenne.

Összegezve, az Anamed Kft. által moduláris monitorként megajánlott termék az 1. pontban foglaltak szerint nem teljesíti Ajánlatkérő minimum elvárásait, valamint a 2. pontban foglalt, a felolvasólapon is szereplő – és tudomásunk szerint utólagosan nem is módosítható – ajánlati paraméter (értékelési szempont) sem teljesül, így álláspontunk szerint az Anamed Kft. ajánlata érvénytelen.

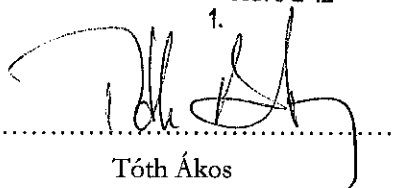
Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az előzetes vitarendezésünkben foglaltak alapján módosítsa a 2017. 06. 06-án megküldött írásbeli összegezést a 2. részajánlati kör vonatkozásában, érvénytelenítse az Anamed Kft. ajánlatát és cégünk, a Medirex Zrt. ajánlatát hirdesse ki a 2. részajánlati kör nyerteseként.

Budapest, 2017. június 7.

Tisztelettel,

Medirex Zrt.

1142 Budapest, Szatmár utca 46/A.
Tel.: +36 1 444 4400 E-mail: info@medirex.hu
Adószám: 11909879-2-42

1.


Tóth Ákos
Medirex Zrt.